

---

# Guida di installazione lampada UV

Codice Noion Aqua: **CMUV0002**

Descrizione: UV Lamp, lunghezza d'onda 185/254nm, 1 pezzo

Codice corrispondente Millipore: **ZMQUVLP01**

Questo prodotto sostituisce la lampada UV corrispondente a Millipore. Prego riferirsi al manuale utente di Millipore per le istruzioni di installazione dettagliate.

## Introduzione

Dove è usato:

- Sistemi Century Milli-Q®
- Sistema piattaforma Integral

Incluso nella scatola: 1 lampada UV

Attrezzi necessari:

- Cacciavite T10
- Cacciavite T20 (Sistema Milli-Q® Century)
- Cacciavite piatto

## Smaltimento della lampada usata

### Attenzione!

La lampada usata contiene mercurio metallico e pertanto dev'essere eliminata dal proprietario in accordo con le normative locali.

È molto importante mantenere la lampada UV perfettamente verticale in qualsiasi momento.

Ciò eviterà la possibilità di rompere la lampada UV.

### Avviso!


La luce della lampada UV è molto dannosa per gli occhi e la pelle. Non accendere mai il sistema o tentare di accendere la lampada UV in qualsiasi modo fino a quando la lampada UV non è all'interno della sua custodia all'interno del sistema d'acqua ultrapura.

**Il fornitore declina ogni responsabilità per tali incidenti legati alla non conformità con questo avviso.**

### Procedura 1 per il sistema Milli-Q® Century:

Una breve descrizione per il processo di installazione descritto sotto:

Step	Azione
1	Mettere il sistema in modalità STANDBY.
2	Spegnere l'elettricità del sistema.
3	Rimuovere il coperchio con il cacciavite.
4	Inserire la lampada UV nel suo alloggiamento in acciaio inossidabile.
5	Disconnettere il connettore dalla lampada UV.
6	Rimuovere la lampada UV dal suo alloggiamento in acciaio inossidabile.
7	Assicurarsi di indossare i guanti. Installare la nuova lampada UV invertendo i passaggi 5 e 4 sopra. Evitare di mettere impronte digitali sulla lampada UV.
8	Rimettere il coperchio del sistema.
9	Accendere il sistema.
Seguire i passi sottostanti per resettare il timer della lampada UV.	
1	Premere i bottoni MEASURE, CLEANING e MENU allo stesso momento.
2	Premere il bottone MENU 4 volte. Fermarsi quando appare la scritta "SERVICE RESET". Premere i bottoni MEASURE e CLEANING allo stesso tempo, la parola "OK" dovrebbe apparire. Questo indica che il timer dell'UV è stato resettato a 0 giorni.
3	Premere il tasto MENU per 2-3 secondi per tornare alla modalità PRE OPERATE o STANDBY.

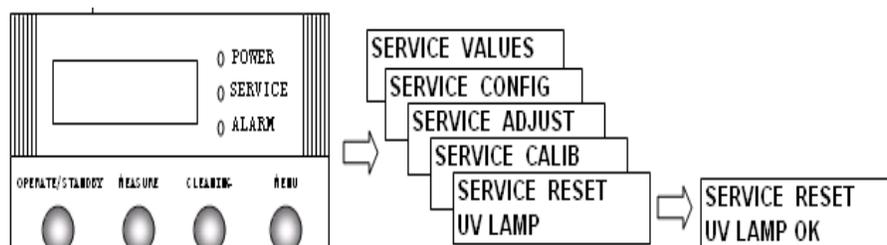

## Procedura 2 per il sistema Integral:

Una breve descrizione per il processo di installazione descritto sotto:

Step	Azione
1	Mettere il sistema in modalità STANDBY.
2	Spegnere la corrente elettrica del sistema e scollegare il cavo di alimentazione.
3	Rimuovere il coperchio laterale sinistro.
4	Individuare la lampada UV e il suo cavo. Estrarre la lampada delicatamente dal suo contenitore.
5	Rimuovere la lampada UV dal suo connettore senza toccare il vetro.
6	Installare la nuova lampada UV. Assicurarsi di indossare i guanti. Evitare di mettere impronte digitali sulla lampada UV.
7	Reinstallare la nuova lampada UV nell'alloggiamento all'interno del sistema. Collegare la lampada UV al connettore della lampada.
8	Riavvitare il coperchio laterale sinistro.
9	Collegare il cavo di alimentazione.
Seguire i passi sottostanti per resettare il timer della lampada UV.	
1	Dal Menu STANDBY, andare in Maintenance.
2	Seguire le istruzioni del display principale.

